


CHAMBRE CATHETER IMPLANTABLE

SCHEMA DE MONTAGE ET FREQUENCE DE CHANGEMENT DE LIGNE

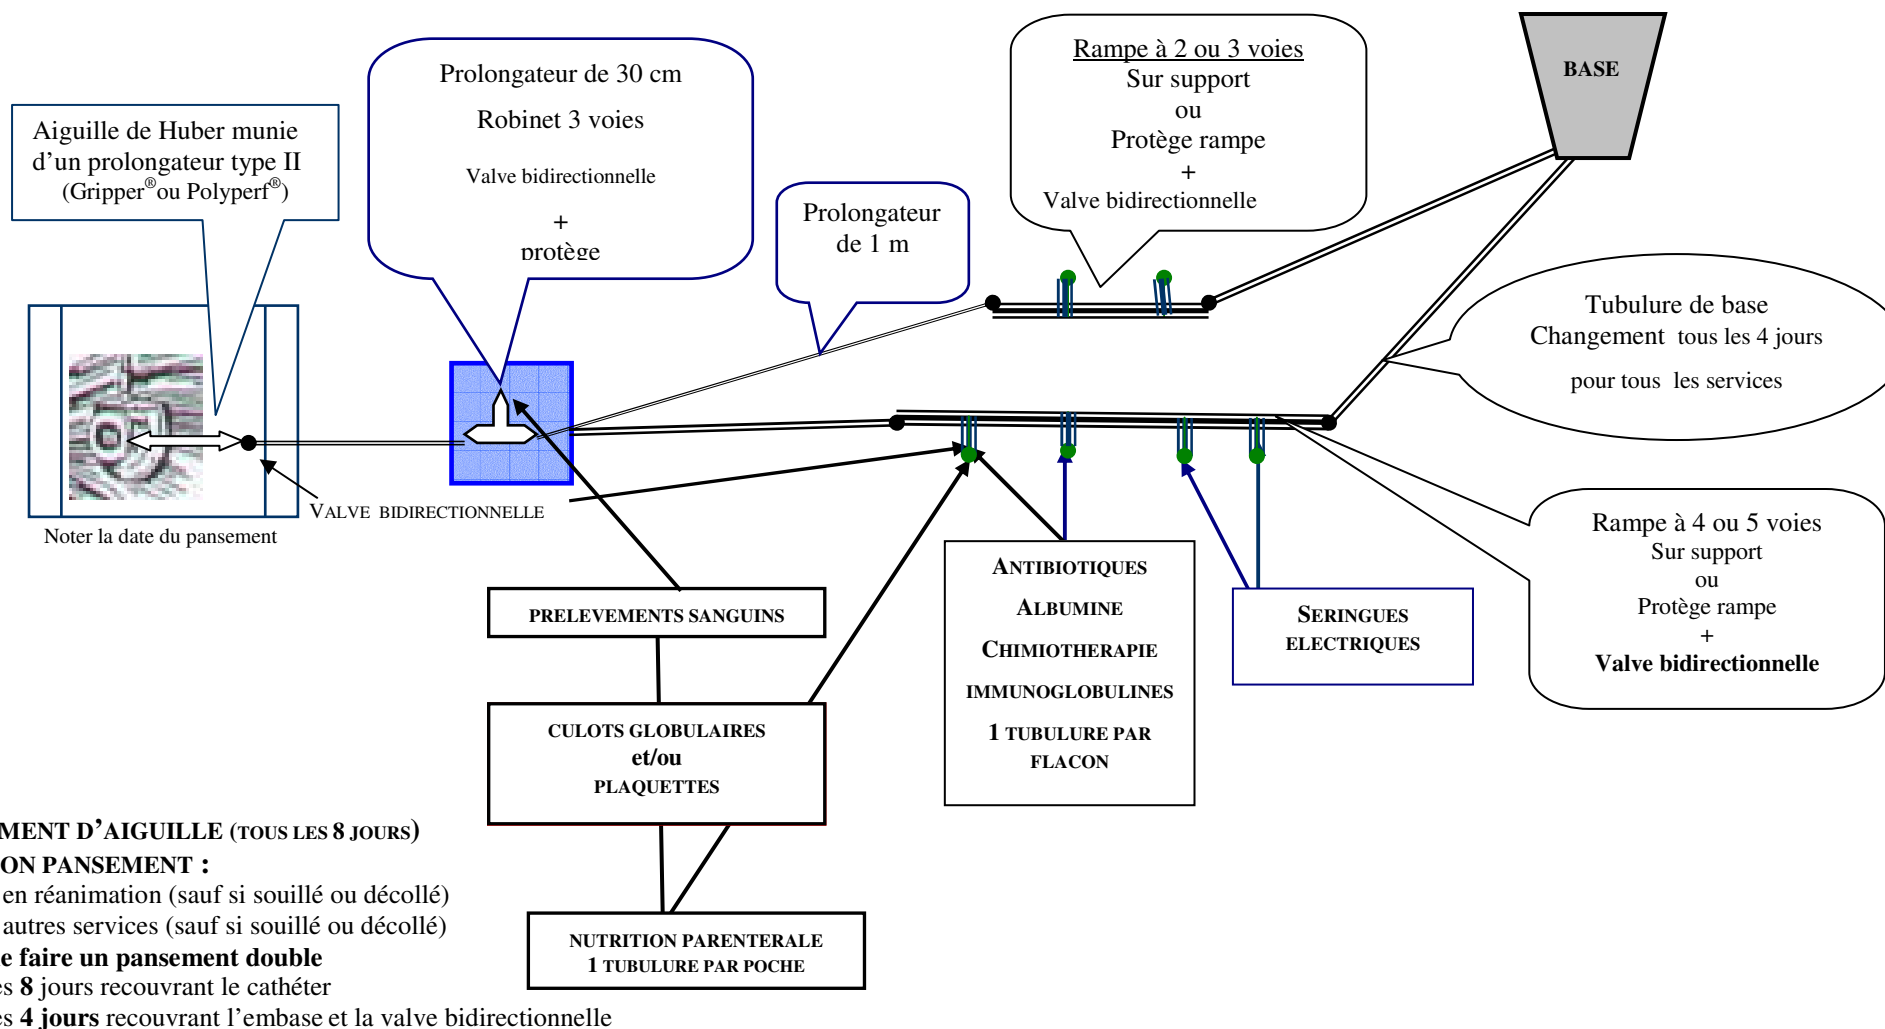

Ligne de perfusion en système clos (valve bidirectionnelle à la sortie du cathéter et sur tous les robinets)

MONTAGE RYTHME DE CHANGEMENT : TOUS LES 4 JOURS